



ALTEST s.r.o.  
Jugoslávská 124 a  
613 00 Brno  
Česká republika  
Tel. +420541210101  
E-mail. info@altest.cz  
www.altest.cz

Dräger

## Dräger DrugTest® 5000 Testovací systém pro detekci užívání drog

Žádné pipetování, odkapávání a měření času:  
Sběr vzorku ústní tekutiny je s přístrojem Dräger DrugTest® 5000 rychlý a snadný. Vzorek lze na místě ihned analyzovat a získat přesné výsledky.



### ODBĚR A ANALÝZA V JEDNOM SYSTÉMU

Systém pro analýzu drog Dräger DrugTest 5000 se skládá ze systému pro odběr vzorku Dräger DrugTest 5000 Test Kit a analyzátoru Dräger DrugTest 5000 Analyzer. Máte tak k dispozici vše, co potřebujete pro první vyhodnocení.

### SNADNÝ A RYCHLÝ SBĚR VZORKŮ

Snadné okamžité použití, kdykoli je třeba

Testovací sada, Dräger Drugtest 5000 Test-Kit, je snadno použitelný systém pro odběr vzorku. Chcete zkontrolovat podezřelou osobu? Stačí odstranit kryt a předat testovací kazetu testované osobě.

### Hygienicky a bezbolestně:

#### Odběr bez vzorku krve

Testovaná osoba pohybuje aktivně horní částí sběrače mezi tváří a dásněmi dopředu a dozadu, až integrovaný indikátor změnou zabarvení oznámí, že byl vzorek odebrán v dostatečném množství. Obvykle to trvá méně než minutu a nikdy ne déle, než čtyři minuty. Testovaná osoba vám vrátí kazetu – a vy se nedostanete do kontaktu se slinami.

### Modrá znamená, že vzorek byl odebrán

Testovací kazeta systému Dräger DrugTest 5000 automaticky indikuje ukončení procesu odběru vzorku: Pokud sběrač sebral dostatečné množství slin, indikátor se zbarví modře a proces sběru vzorku je dokončen. Následně vložte testovací kazetu a patronu přímo do analyzátoru Dräger DrugTest 5000 Analyzer pro vyhodnocení.

### DALŠÍ VÝHODY TESTOVACÍ SADY DRÄGER DRUGTEST® 5000 TEST KIT:

- vysoký stupeň shody výsledků s krevními vzorky a s limity pro detekci (potvrzeno nezávislými studiemi)
- extrémně nízké detekční limity pro THC, jako hlavní aktivní složky marihuany
- jasné zobrazení výsledků na displeji
- hygienický odběr vzorků a analýza
- vysoká úroveň akceptace mezi uživateli i testovanými osobami
- snadné použití s bezpečnostními rukavicemi
- k dispozici různé konfigurace (podle modelu lze najednou detekovat různé substance)
- lze používat při teplotě mezi 4 °C a 40 °C
- lze uchovávat v původním balení při teplotě do 30 °C, aniž by došlo ke zhoršení funkce



D-54724-2012

Analýzátor Dräger DrugTest 5000 analyzátor – odeberte vzorek a ihned jej analyzujte




D-31774-2011

Testovací sada Dräger DrugTest® 5000 Test-Kit: nekomplikované, rychlé, spolehlivé a bezpečné testy na drogy



**ALTEST s.r.o.**  
Jugoslávská 124 a  
613 00 Brno  
Česká republika  
Tel.+420541210101  
E-mail. info@altest.cz  
[www.altest.cz](http://www.altest.cz)

**DRÄGER DRUGTEST® 5000 ANALYZER**

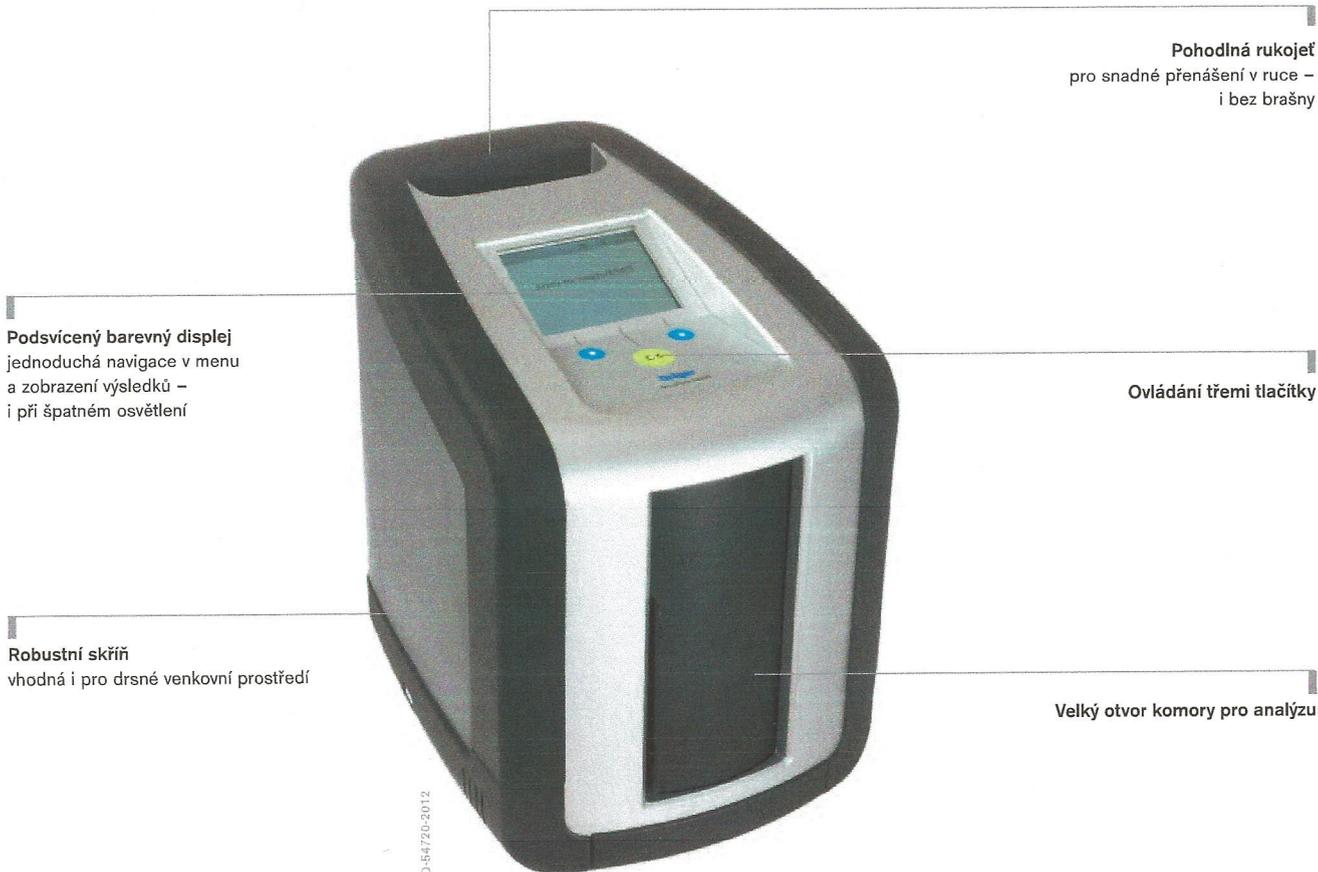

**Pohodlná rukojeť**  
pro snadné přenášení v ruce –  
i bez brašny

**Podsvícený barevný displej**  
jednoduchá navigace v menu  
a zobrazení výsledků –  
i při špatném osvětlení

**Ovládání třemi tlačítky**

**Robustní skříň**  
vhodná i pro drsné venkovní prostředí

**Velký otvor komory pro analýzu**

**DRÄGER DRUGTEST 5000 ANALYZER:  
OKAMŽITÉ VYHODNOCENÍ**

**Vložte testovací kazetu a patronu, spustí se vyhodnocení, hotovo**

Vzorek slin lze vyhodnotit ihned po odběru. Stačí vložit testovací kazetu a patronu do analyzátoru – okamžitě se spustí proces vyhodnocení.

**Jednoduchý a bezpečný provoz –  
i v nepříznivých podmínkách**

Dokonce i v hektické situaci: analyzátor ovládáte pouze třemi tlačítky. Provoz je řízen prostřednictvím menu. Stačí dodržovat jednoduché textové pokyny.

**Rychlý a komfortní:  
výsledky během několika minut**

Jakmile je přístroj spuštěn, analýza se zahájí automaticky. Nemusíte nad ničím přemýšlet a máte volné ruce pro jiné činnosti. Výsledky se zobrazí po několika minutách.

**Snadno čitelný barevný displej**

Barevný displej je osvětlený. Máte tak přehled nad situací i při snížených podmínkách viditelnosti. Displej lze číst bez problémů i ze vzdálenosti nebo z úhlu.


**Jasně výsledky měření bez nutnosti  
další interpretace**

Analýzátor Dräger Drugtest 5000 Analyzer zobrazuje výsledky měření v naprosto srozumitelné textové podobě. Proto nemůže dojít k chybné interpretaci.



D-52608-2012

Analyzátor Dräger DrugTest 5000® Analyzer a mobilní tiskárna s testovací sadou a transportní brašnou Dräger (včetně napájecího adaptéru 12 V)

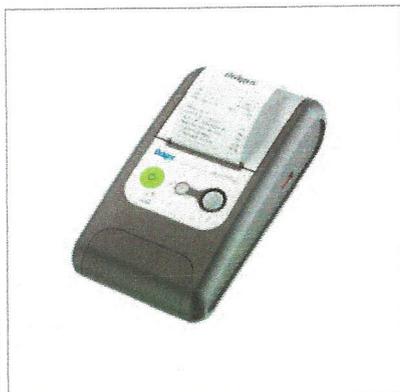

ST-8404-2006

Mobilní tiskárna Dräger Mobile Printer



ST-3461-2003

Kompaktní klávesnice



ST-13211-2007

Přepravní box

#### Vyhodnocení vzorků v každé situaci

Díky trvale integrované dobíjecí baterii budete nezávislí na externím zdroji napájení a analyzátor bude připraven k použití kdykoli a kdekoli. Standardně můžete provozovat systém se zdrojem napětí 230 V nebo adaptérem do auta 12 V.

#### Ukládání a snadná správa 500 výsledků měření

Přístroj uloží posledních 500 výsledků měření včetně data a času. Pomocí klávesnice nebo čtečky čárového kódu můžete vložit další podrobnosti k měření. Výsledky můžete vytisknout přímo na místě na mobilní tiskárnu Dräger Mobile Printer. Chcete-li data dále spravovat, můžete je přenést do PC přes rozhraní USB.

#### Hmotnost 4,5 kg pro přepravu

Analyzátor se snadno přenáší. Dräger dodává odpovídající transportní brašnu nebo robustní přepravní box pro snadnou a bezpečnou přepravu přístroje a jeho příslušenství.

#### DALŠÍ VÝHODY

##### DRÄGER DRUGTEST® 5000 ANALYZER:

- funkce integrované samokontroly: není třeba pololetní kalibrace
- množství příslušenství (např. transportní brašna, nabíječka nebo kompaktní klávesnice)

#### SYSTEM DETEKUJE NÁSLEDUJÍCÍ SKUPINY LÁTEK:


- Amfetaminy
- Benzodiazepiny
- Delta-9-tetrahydrokanabiol (THC)
- Kokain
- Metamfetaminy
- Opiáty
- Metadon



**ALTEST s.r.o.**  
 Jugoslávská 124 a  
 613 00 Brno  
 Česká republika  
 Tel.+420541210101  
 E-mail. info@altest.cz  
 www.altest.cz


## DRÄGER DRUGTEST® 5000

ST-319-2008

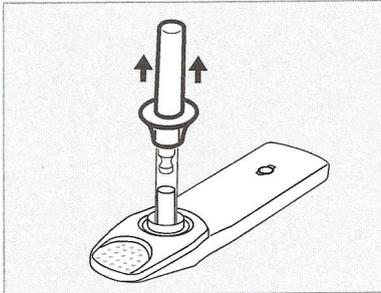


- Sejměte kryt
- Předějte testovací kazetu testovanému subjektu

D-4780-2011

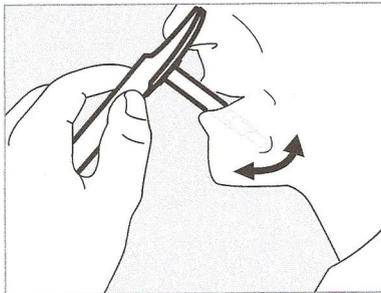

- Testovaný subjekt aktivně pohybuje sběračem v ústech dopředu a dozadu, až se indikátor zbarví modře.

D-4779-2011

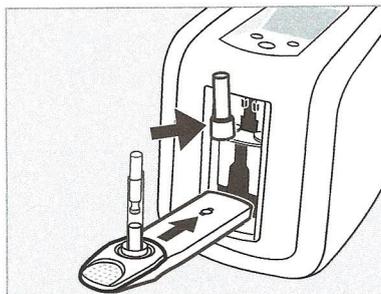

- Vložte testovací kazetu a patronu do analyzátoru. Zavřete dvířka. Automaticky se zahájí analýza
- Výsledky se zobrazí po několika minutách.



**ALTEST s.r.o.**  
**Jugoslávská 124 a**  
**613 00 Brno**  
**Česká republika**  
**Tel. +420541210101**  
**E-mail. info@altest.cz**  
**www.altest.cz**

## DRÄGER DRUGTEST® 5000 TEST KITS




**ALTEST s.r.o.**  
 Jugoslávská 124 a  
 613 00 Brno  
 Česká republika  
 Tel. +420541210101  
 E-mail. [info@altest.cz](mailto:info@altest.cz)  
[www.altest.cz](http://www.altest.cz)

**Dräger SSK 5000:****Detekce drog z povrchů a neznámých látek**

Potřebujete na místě vědět, zda jsou na volantu zjištělné stopy drog nebo zda obsah podezřelého zavazadla obsahuje drogy? Snadnou odpověď na tyto otázky získáte po odebrání vzorku drogy sběračem Dräger SSK 5000 a přenosem vzorku do testovací sady Dräger DrugTest 5000 Test Kit. Vzorek pak můžete analyzovat v analyzátoru Dräger DrugTest 5000 Analyzer.